

# SMPT 4~20mA 电流通讯方式设置

SMPT 提供的 4~20mA 通讯方式，除了在 SMPT 实验软件里面进行变量设置外，还需要通过“DCON\_Utility”软件进行设置，软件图标如下图所示：




如果在桌面找不到：

- 1) 找到 C:\ICPDAS\DCON\_Utility，在该路径下可找到可执行文件；
- 2) 如果上述路径也找不到，请到网盘下载，并自行安装：


网盘链接：<http://pan.baidu.com/s/1c0wJBNy>，提取密码：pbxq

## 操作步骤


1. 单击桌面右下角“Hardwaremanger”软件图标，右键退出；




2. 双击运行“DCON\_Utility”软件，选择菜单栏中的“COM Port”，如下图所示：

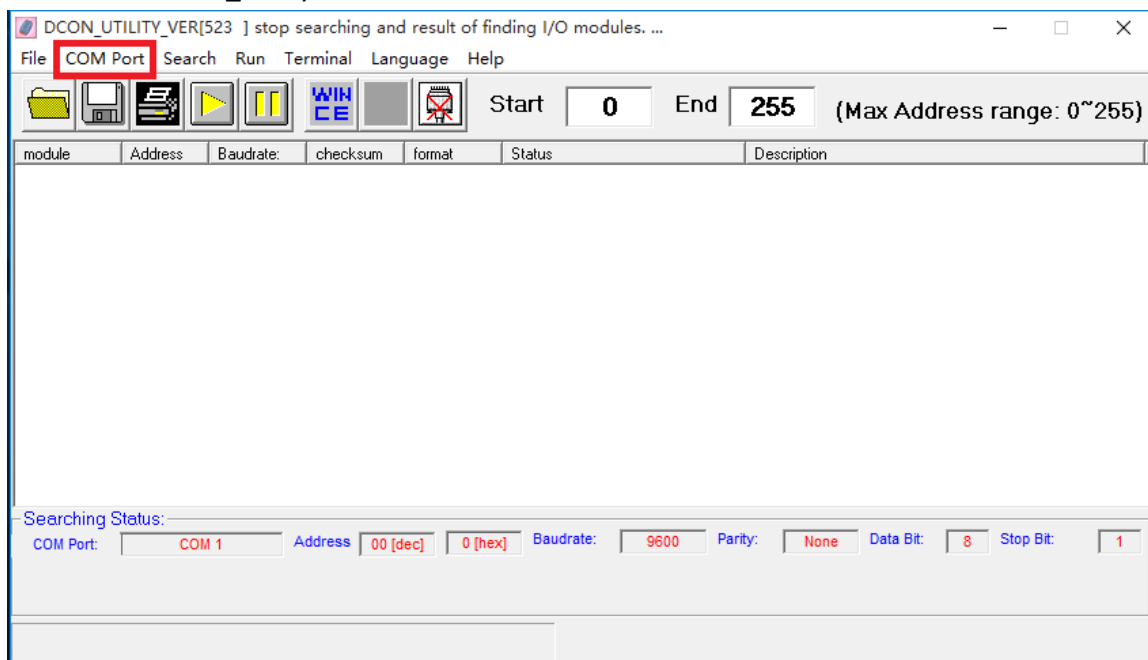

3. 在弹出的对话框中，在下图红框处选择“COM2”，然后单击 OK 进行保存：

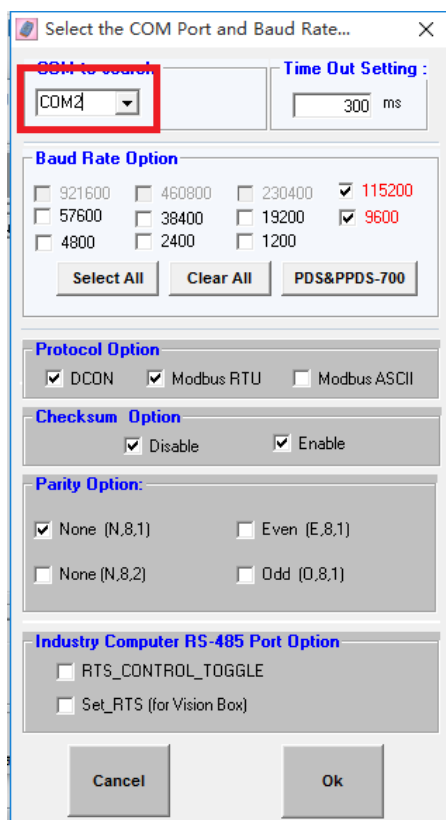

4. 按下工具栏中的运行按钮，进行模块搜索：

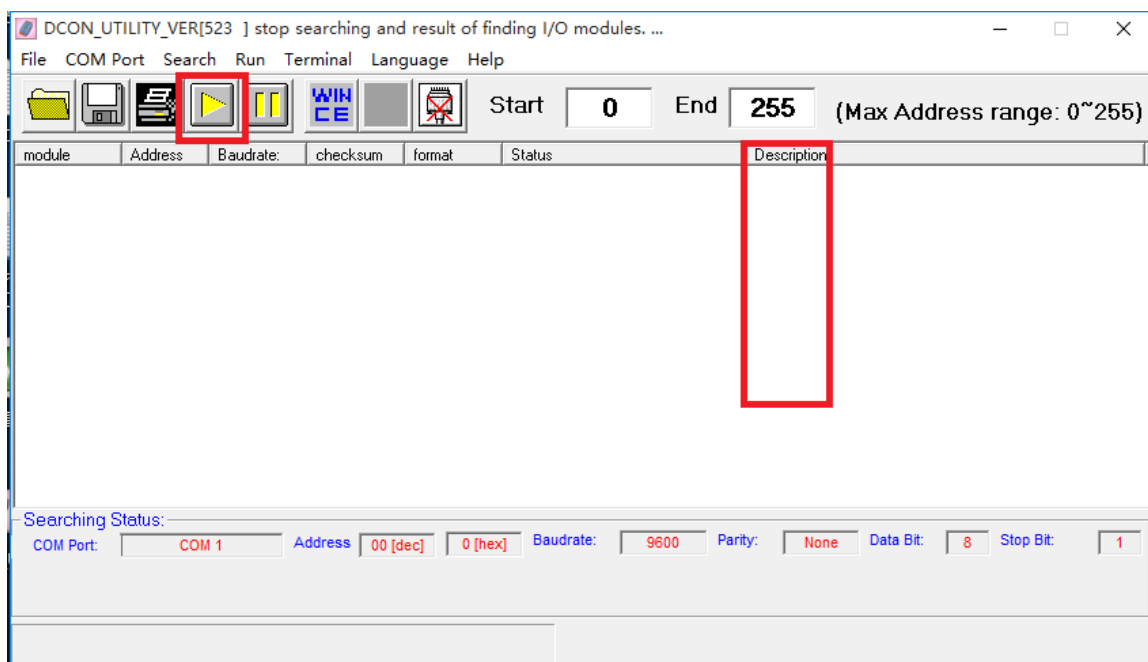

5. 如果操作无误，在软件的空白文档区将会出现搜索结果，双击“Description”这一列显示为“AO”的模块（共两个），将其量程均改为“4~20mA”，保存后退出 DCON 软件；
6. 重新运行“Hardwaremanger”软件。